
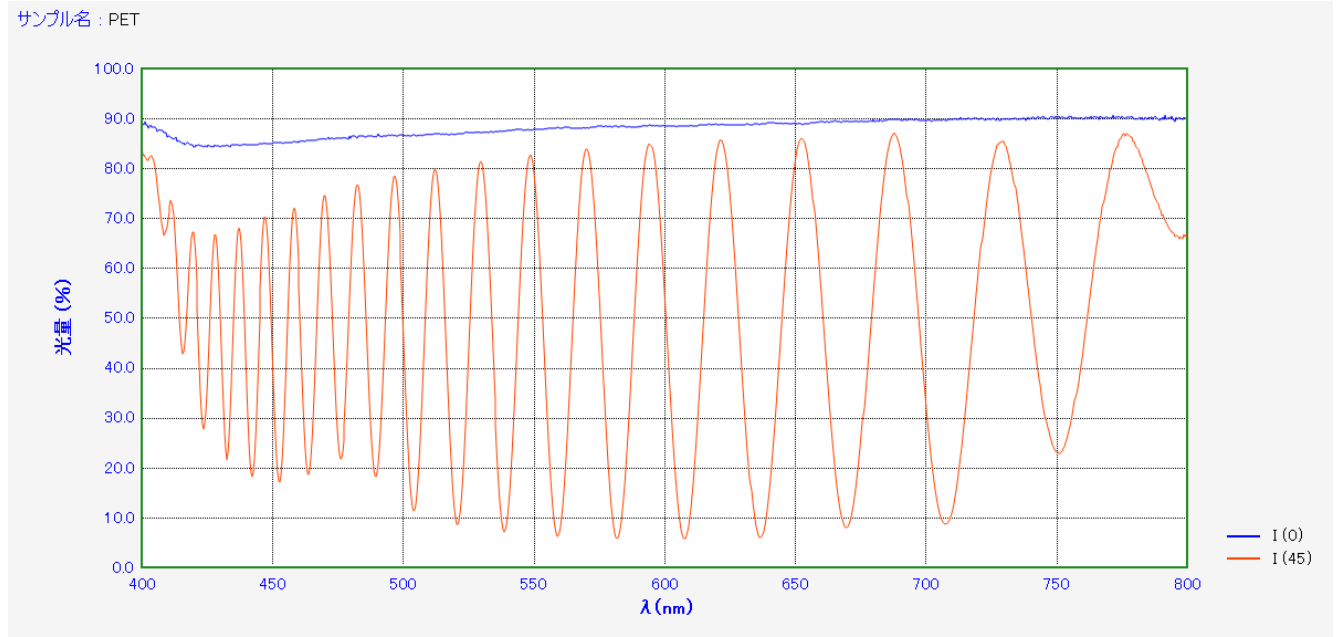


面内位相差測定(分光器オプション:SPC)

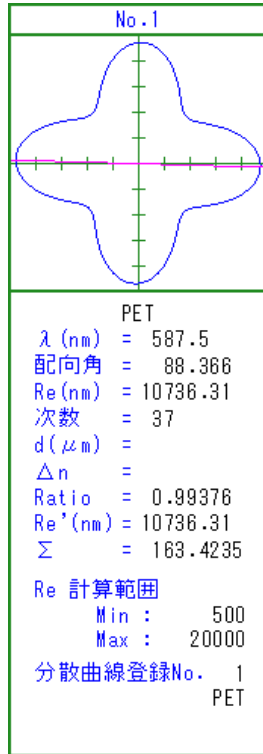

- λ : 測定波長
- 配向角 : 遅相軸方位(次数自動決定の時)
- Re : レターデーション
- 次数 : 光学次数m
- I(0) : 平行ニコル透過光量(配向角方位)
- I(45) : 平行ニコル透過光量(配向角+45度方位)